SQ Submerged Qualified

Имплантаты, созданные
для немедленной нагрузки

DENTIS

ДЛЯ ОДНОМОМЕНТНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ С НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКОЙ!

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ ALL-ON-X!

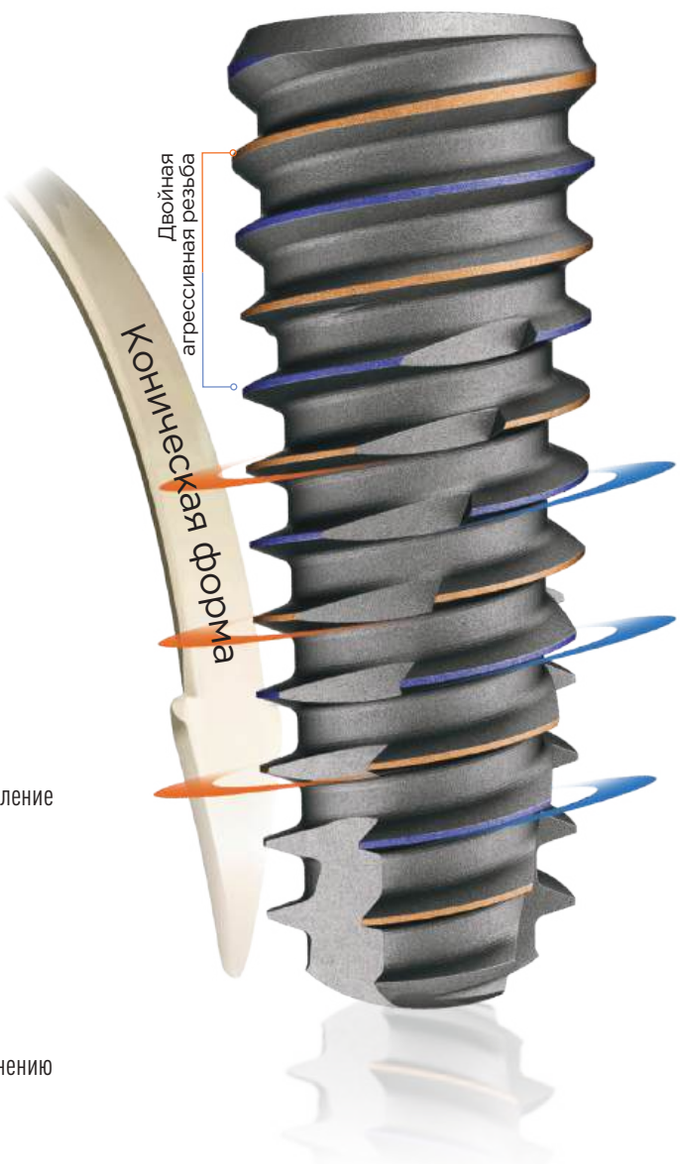

Высокая первичная стабильность
Коническая форма и двойная агрессивная резьба.

Имплантаты погружного типа
Легко устанавливается на необходимую глубину.

Мягкая установка и полный контроль погружения
Спираль с широким режущим краем.

Поверхность C-SLA
Грубозернистая пескоструйная обработка титана и последующее травление кислотой способствуют ускоренной остеоинтеграции.

Универсальность
Совместимость с ортопедическими компонентами DENTIS и других южнокорейских имплантационных систем.

Надежное конусное соединение имплантат / абатмент
Равномерное распределение нагрузки благодаря внутреннему соединению под углом 11° и креплению шестигранником.

Игорь Григорьевич Хегай,
к.м.н., стоматолог хирург-имплантолог

«Линейка имплантатов SQ была создана специально для расширения клинических возможностей имплантации. Это был ответ на запрос докторов иметь имплантаты с гораздо большей первичной стабильностью после операции для одномоментной имплантации, для немедленной нагрузки и для создания таких популярных на сегодняшний день ортопедических конструкций, как условно-съемные протезы с винтовой фиксацией на 4,5 или 6 имплантатах».

DENTIS

C-SLA™ поверхность

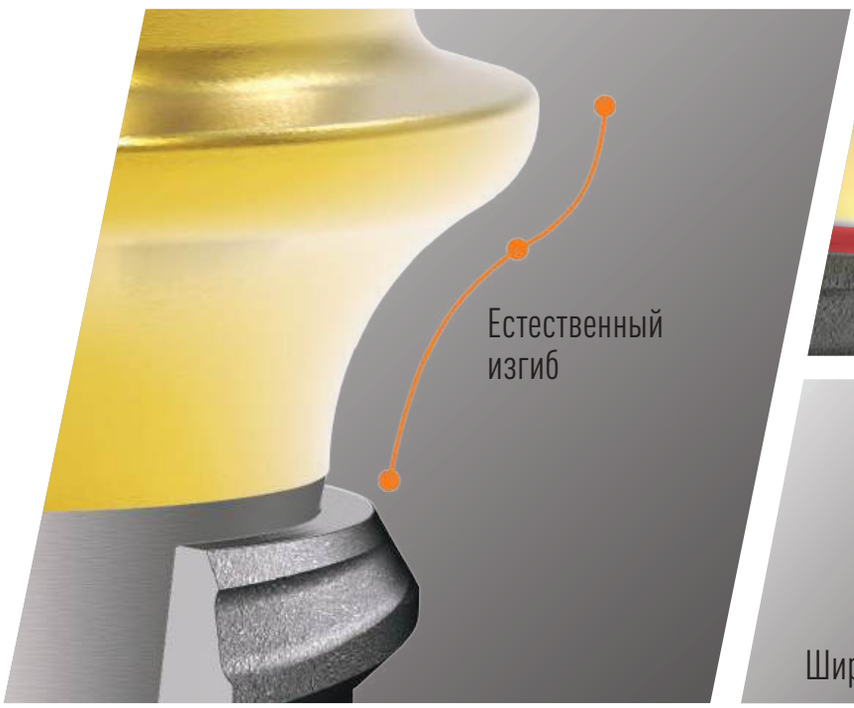

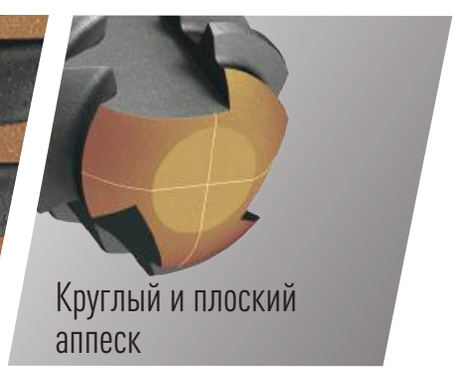

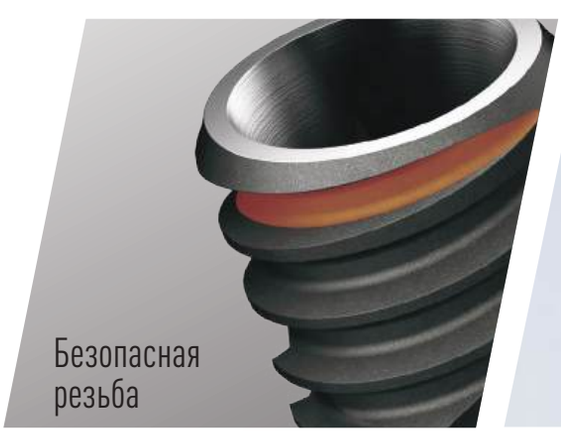

SQ Submerged Qualified

Содержание

Характеристики имплантатов SQ	6
Короткие и широкие имплантаты SQ	8
Хирургический набор SQ SHORT & WIDE	9
Детализация упаковки и этикетки	10
Соединение имплантат-абатмент	11
Заглушка	11
Имплантат SQ. Размерный ряд	12
Хирургический набор SQ	16
Последовательность сверления	17
Навигационная система SQ GUIDE	19
SQ Sinus Guide	20
Последовательность протезирования для системы SQ	21
Формирователь десны	22
Мульти Юнит система	24
Последовательность протезирования для Мульти Юнит абатментов	25
Схема протезирования для CAD/CAM абатментов	30
CAD/CAM Элементы	31
Сканбоди	32
Сканбоди Pro	34

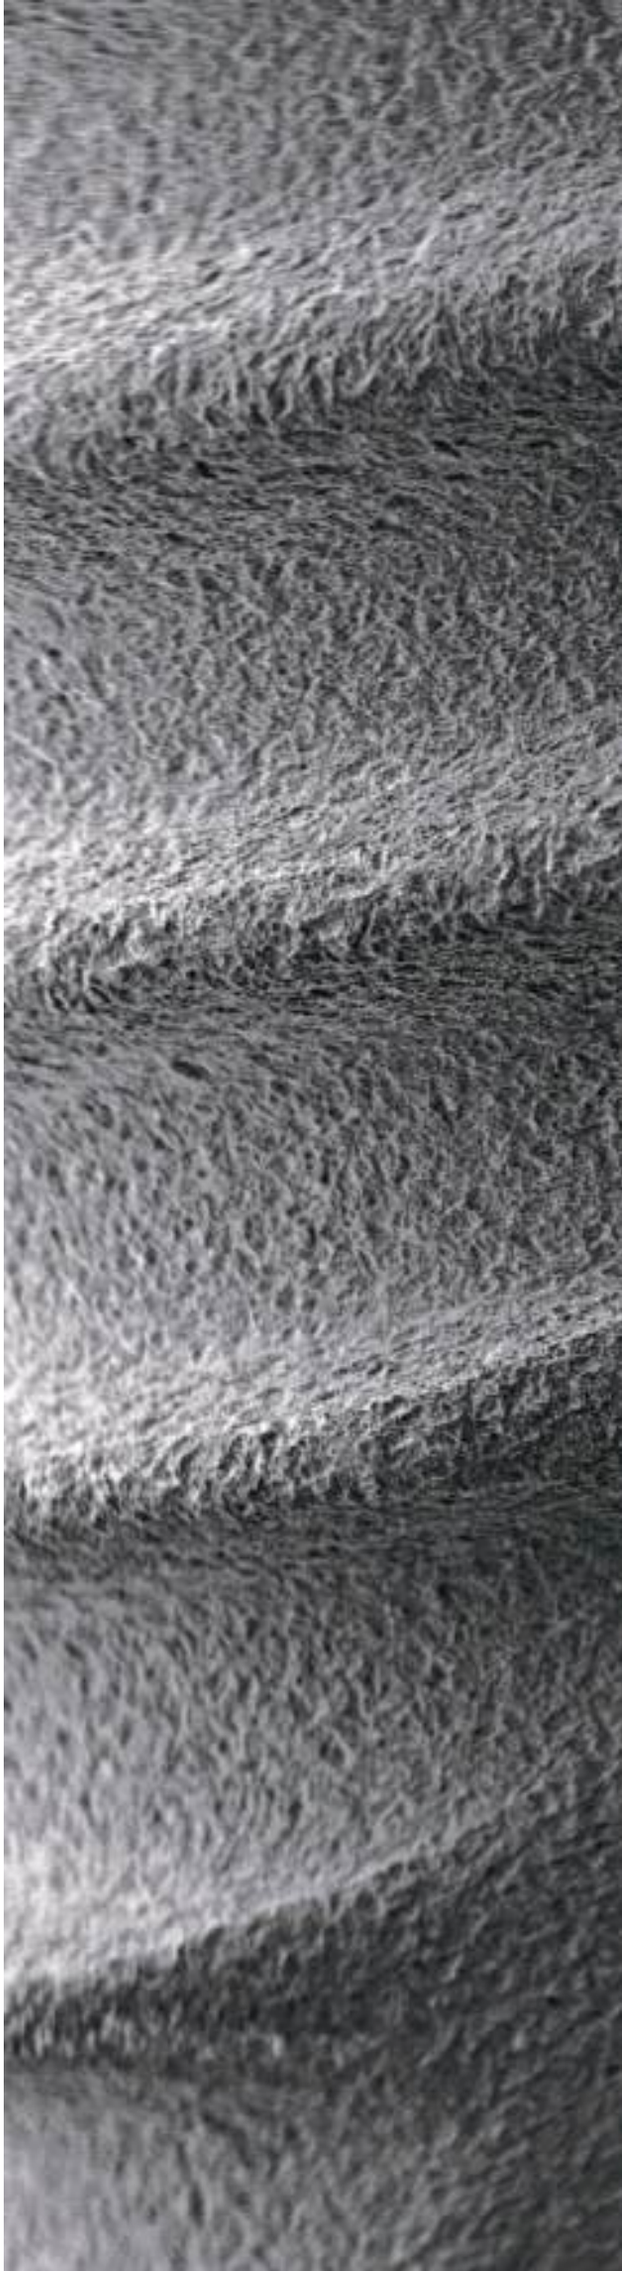

× 2,000

× 5,000

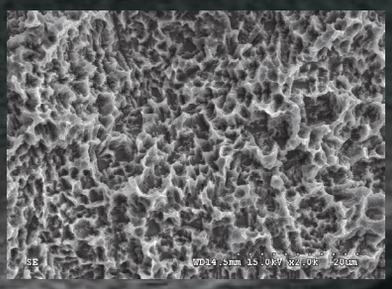

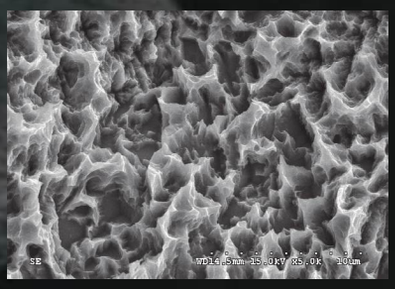

Поверхность C-SLA

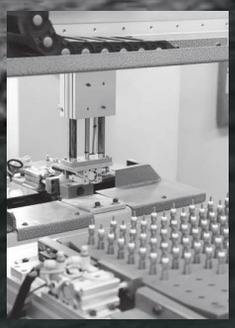

Контроль качества

Машина вакуумной очистки

Характеристики имплантатов SQ

C-SLA™ поверхность для одномоментной имплантации с немедленной нагрузкой!
SQ - имплантат погружного типа, который легко устанавливается на необходимую глубину. Надежная платформа исключает разрушение имплантата и совместима со всеми абатментами DENTIS.

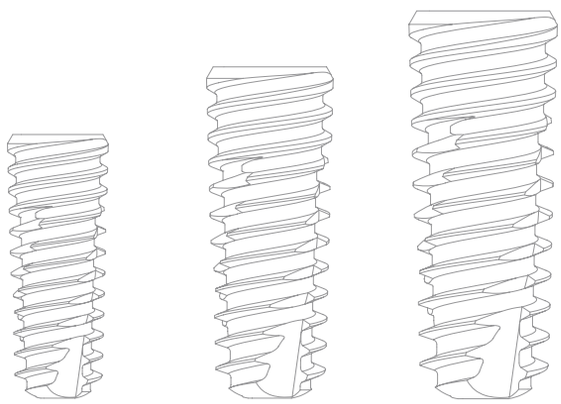

SQ Submerged Qualified

Лёгкая установка и эффективная остеоинтеграция

Александр Алексеевич Данилов,
врач стоматолог хирург-имплантолог, ортопед

Как врач-хирург с более чем 10-летним опытом работы с различными имплантационными системами, могу уверенно сказать, что DENTIS выделяется своей надежностью и универсальностью в хирургическом протоколе. Чистота поверхности имплантатов DENTIS, подтвержденная сертификатом независимой лаборатории, обеспечивает высокий уровень безопасности и остеоинтеграции.
Ключевой особенностью линейки SQ является возможность немедленной загрузки. Также я высоко ценю богатый выбор цифровой протетики и возможность полного цифрового переноса положения имплантов при эстетическом протезировании.

Высокая первичная стабильность

- Конический дизайн.
- Двойная открытая резьба.

Более плавная установка

- 3 лезвия и широкая спиральная режущая кромка.

Простой и понятный контроль глубины погружения

- Длина имплантата от 6 до 14 мм.
- Самонарезающие бороздки могут облегчить контроль глубины без дополнительного препарирования.

Улучшенное соединение имплантат-абатмент

(совместимы с линейками OneQ и SQ)

Поверхность C-SLA

- Увеличенная на 200% площадь поверхности по сравнению с поверхностью RBM (пескоструйная обработка частицами бета-трикальцийфосфата).

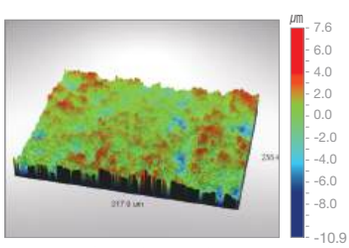

Sdr of RBM : 43.93%

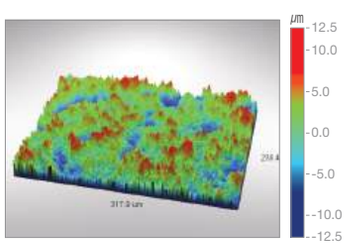

Sdr of SLA : 139.18%

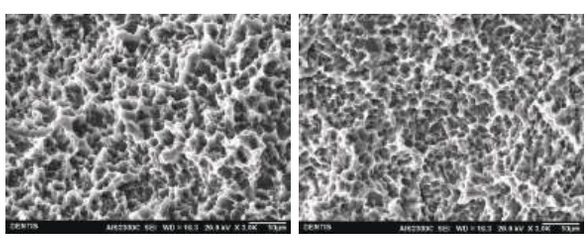

Тщательная очистка

- 30 этапов автоматической системы очистки, включая очистку вакуумом.
- Строгий контроль качества и безопасная поверхность C-SLA без следов производственных загрязнений.

Эффективное сверление

- Идеальная эффективность сверления благодаря ступенчатому дизайну и высокой режущей способности свёрел.
- Сверла с ограничителями.
- Возможность забора аутотрансплантата.

Короткие имплантаты SQ

для установки в область премоляров и моляров при недостаточном объеме костной ткани. Безопасная и надежная фиксация. Подходят для немедленной нагрузки.

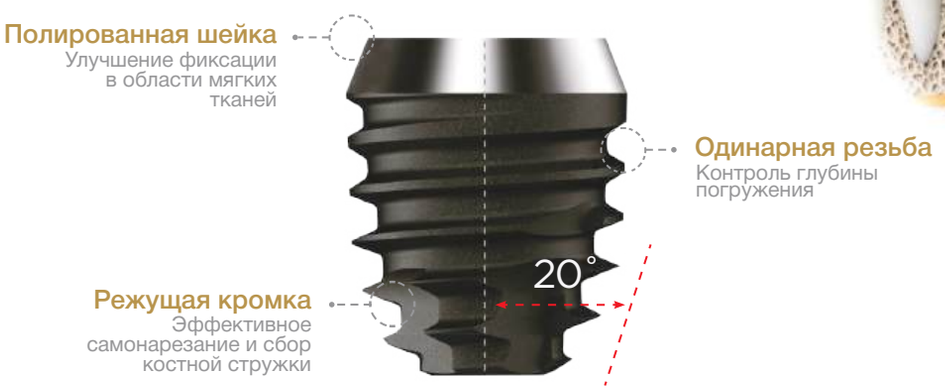

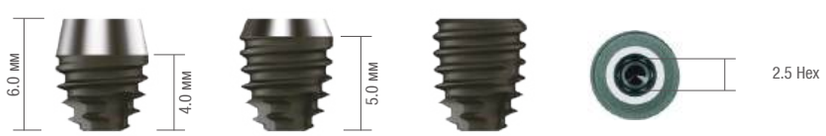

Диаметр импланта	Длина	Шейка	Код
5.0 мм	6.0 мм	2.0 мм	DSSFR5004
		1.0 мм	DSSFR5005
		0 мм	DSSFR5006

Последовательность сверления

Установите имплантат ниже уровня костной ткани на 0,5-1,0 мм

∅5,0 × 6 мм

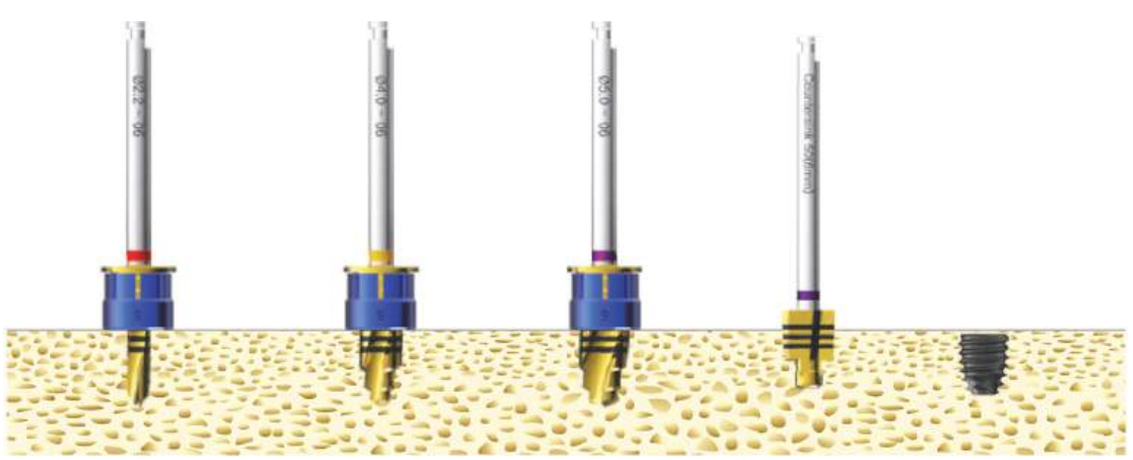

Нормальная кость

Твёрдая кость

Широкие имплантаты SQ

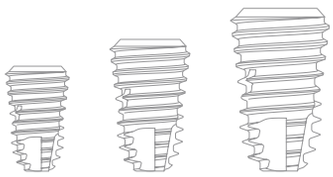

SQ Submerged Qualified

Специальное решение при низкой плотности кости и для области после экстракции зуба

6 мм	7 мм	8 мм	10 мм	12 мм
	⌀6 / ⌀7 / ⌀8			

Хирургический набор SQ SHORT & WIDE

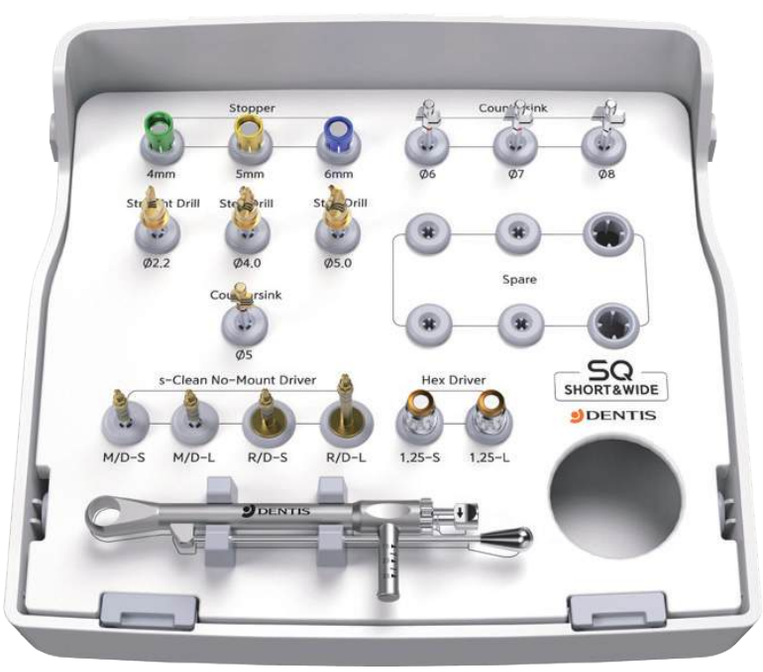

Код
DSQSWK

За 40 имплантов

Детализация упаковки

Капсула

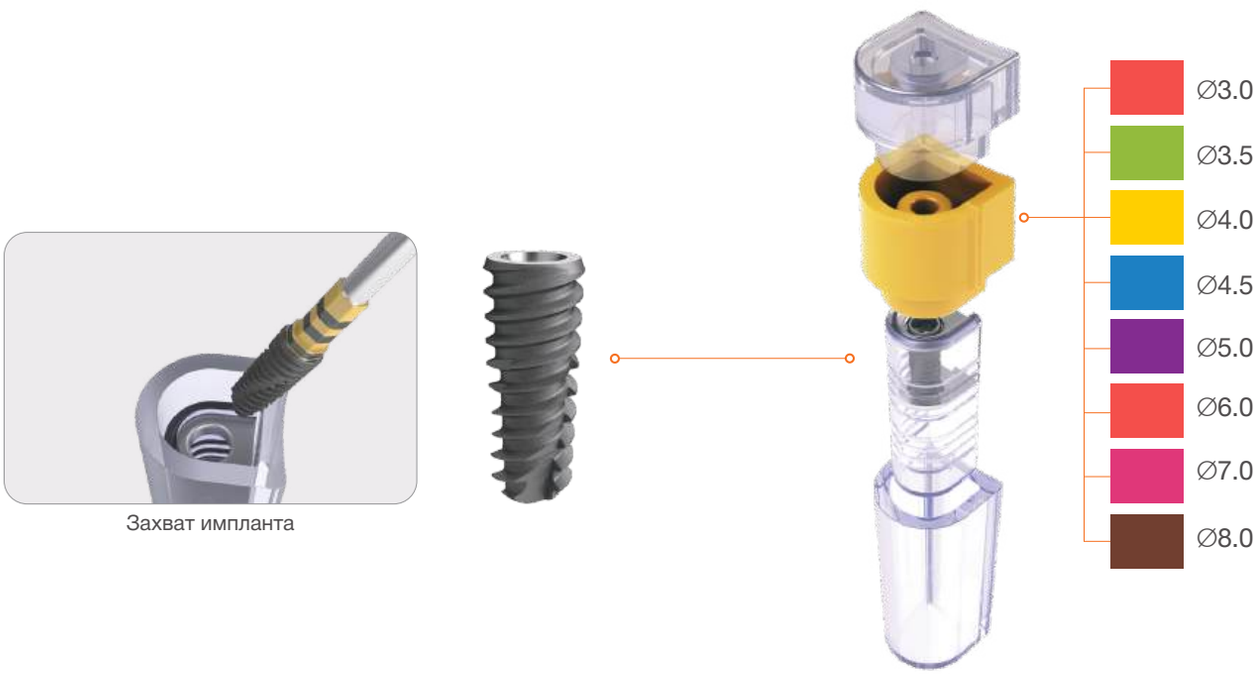

Детализация этикетки

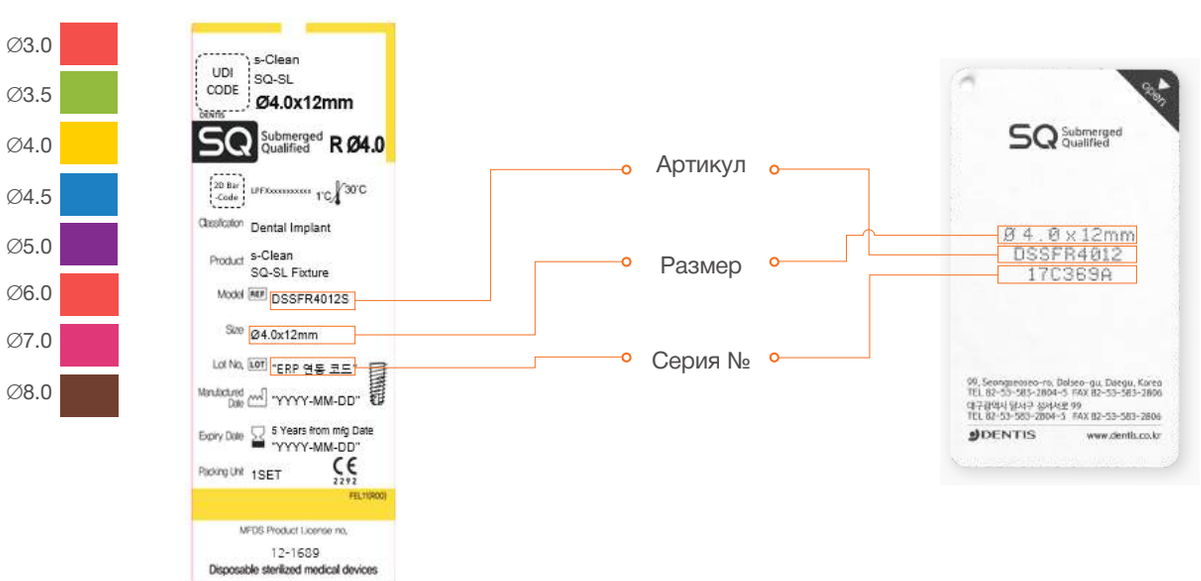

Соединение имплантат-абатмент

Узкий

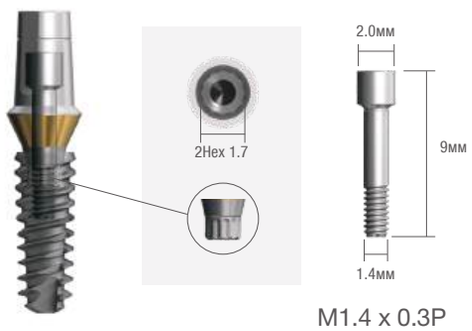

M1.4 x 0.3P

Рекомендуемый торк: 20 Нсм

Обычный / широкий

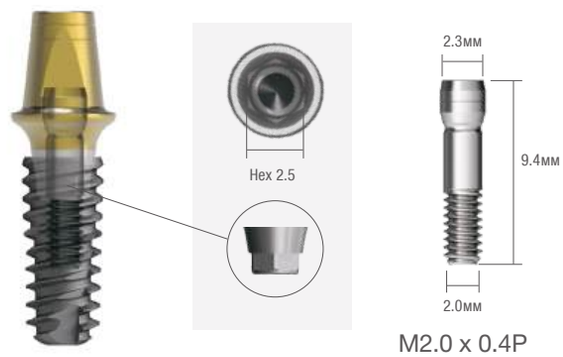

M2.0 x 0.4P

Рекомендуемый торк: 30 Нсм

Заглушка

Заглушки не входят в комплектацию имплантата, их необходимо приобретать дополнительно.
Рекомендуемый торк – 10 Нсм

Заглушка Узкая

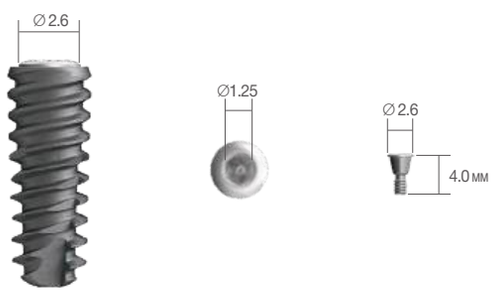

Код
DSOFCS

Заглушка Стандартная / Широкая

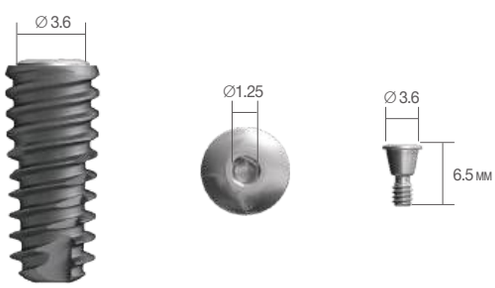

Код
DSCSM

Имплантат SQ. Размерный ряд

1.7 2Hex



2.5 Hex

A	Диаметр, мм	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
	Имплантат								
B	Длина, мм	8/10/12/14	7 / 8 / 10 / 12 / 14				6 / 7 / 8 / 10 / 12		
C	Hex	1.7 2Hex		2.5 Hex					
D	Цвет								
Область установки		Передняя	Передняя	Передняя	Премоляр	Моляр	Моляр	Моляр	Моляр

Узкие

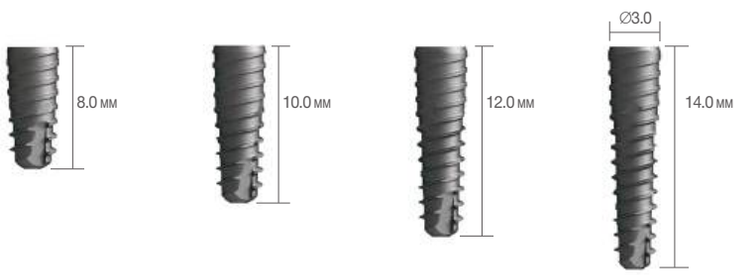

Диаметр	Длина	Код
∅3.0	8.0 мм	DSSFN3008
	10.0 мм	DSSFN3010
	12.0 мм	DSSFN3012
	14.0 мм	DSSFN3014

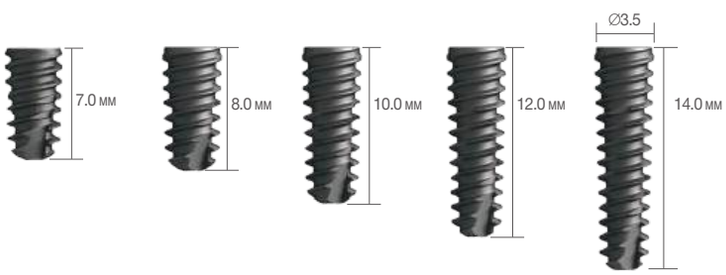

Диаметр	Длина	Код
∅3.5	7.0 мм	DSSFN3507
	8.0 мм	DSSFN3508
	10.0 мм	DSSFN3510
	12.0 мм	DSSFN3512
	14.0 мм	DSSFN3514

Стандартные

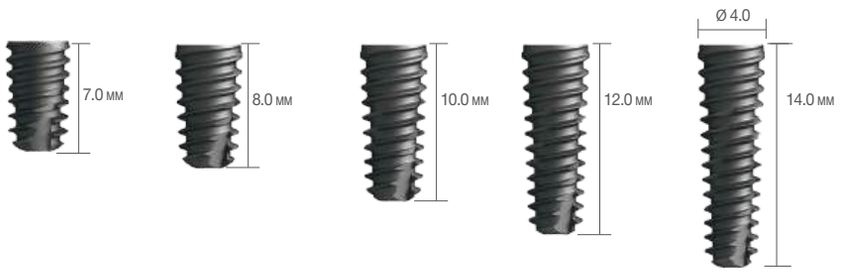



Диаметр	Длина	Код
Ø 4.0	7.0 мм	DSSFR4007
	8.0 мм	DSSFR4008
	10.0 мм	DSSFR4010
	12.0 мм	DSSFR4012
	14.0 мм	DSSFR4014

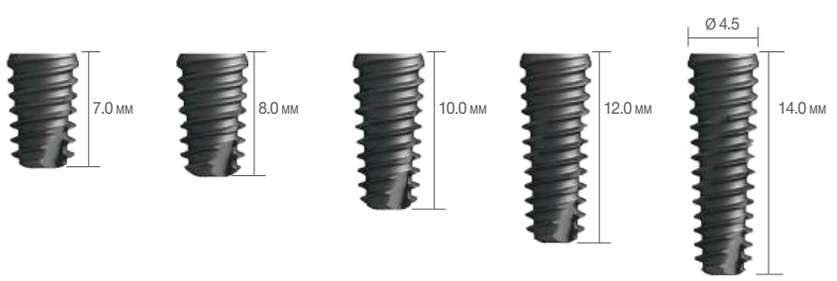



Диаметр	Длина	Код
Ø 4.5	7.0 мм	DSSFR4507
	8.0 мм	DSSFR4508
	10.0 мм	DSSFR4510
	12.0 мм	DSSFR4512
	14.0 мм	DSSFR4514

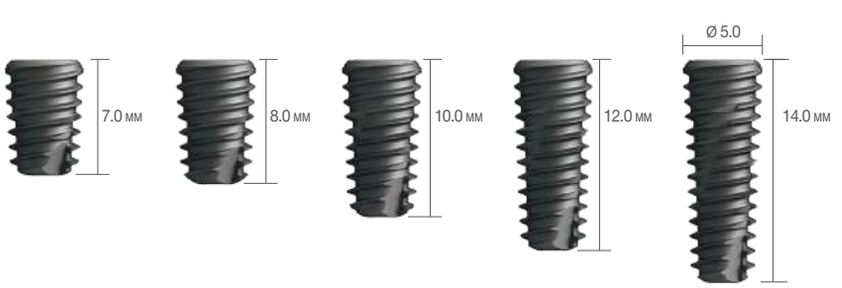



Диаметр	Длина	Код
Ø 5.0	7.0 мм	DSSFR5007
	8.0 мм	DSSFR5008
	10.0 мм	DSSFR5010
	12.0 мм	DSSFR5012
	14.0 мм	DSSFR5014

Широкие



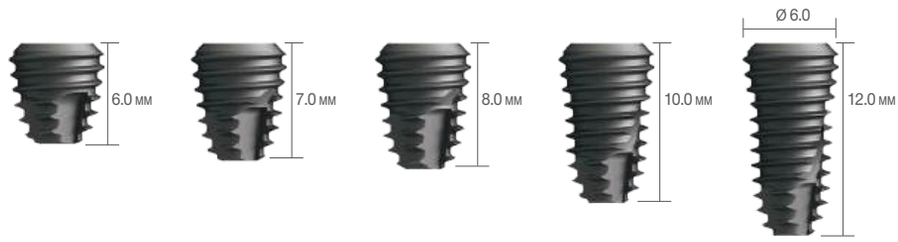

Диаметр	Длина	Код
Ø 6.0	6.0 мм	DSSFW6006
	7.0 мм	DSSFW6007
	8.0 мм	DSSFW6008
	10.0 мм	DSSFW6010
	12.0 мм	DSSFW6012



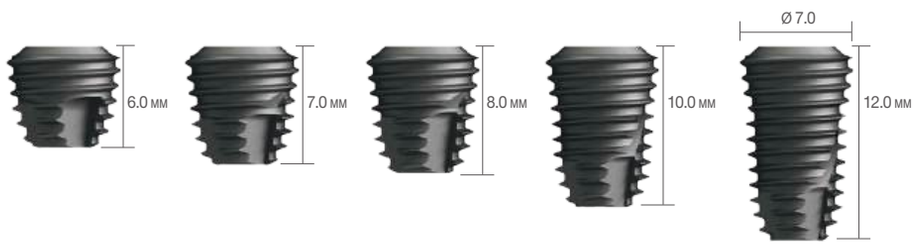

Диаметр	Длина	Код
Ø 7.0	6.0 мм	DSSFW7006
	7.0 мм	DSSFW7007
	8.0 мм	DSSFW7008
	10.0 мм	DSSFW7010
	12.0 мм	DSSFW7012



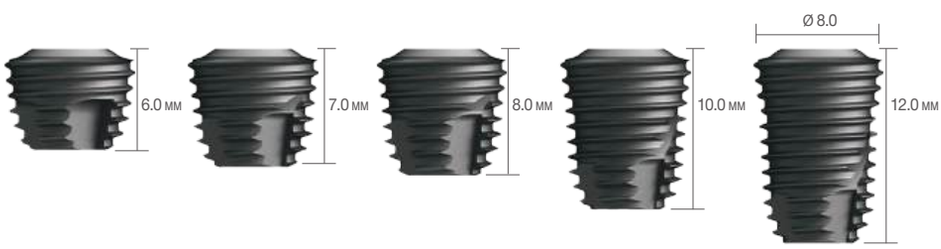

Диаметр	Длина	Код
Ø 8.0	6.0 мм	DSSFW8006
	7.0 мм	DSSFW8007
	8.0 мм	DSSFW8008
	10.0 мм	DSSFW8010
	12.0 мм	DSSFW8012

Хирургический набор SQ

- Надежность и высокая точность – эффективное сверление.
- Возможность забора аутотрансплантата.
- Сверла с ограничителем.
- Ступенчатый дизайн сверел увеличивает эффективность и сокращает время сверления.

DLINDST23

Фреза Линдемана

DDE

Удлинитель сверла

DSQSD2207
DSQSD2208
DSQSD2210
DSQSD2212
DSQSD2214

DSQSTD2814

DSQSTD3507
DSQSTD3508
DSQSTD3510
DSQSTD3512
DSQSTD3514

DSQSTD4007
DSQSTD4008
DSQSTD4010
DSQSTD4012
DSQSTD4014

DSQSTD4507
DSQSTD4508
DSQSTD4510
DSQSTD4512
DSQSTD4514

DSQSTD5007
DSQSTD5008
DSQSTD5010
DSQSTD5012
DSQSTD5014

Сверла

DSQCS35
DSQCS40
DSQCS45
DSQCS50

Опционально

Развертка

Глубиномер

DPDG

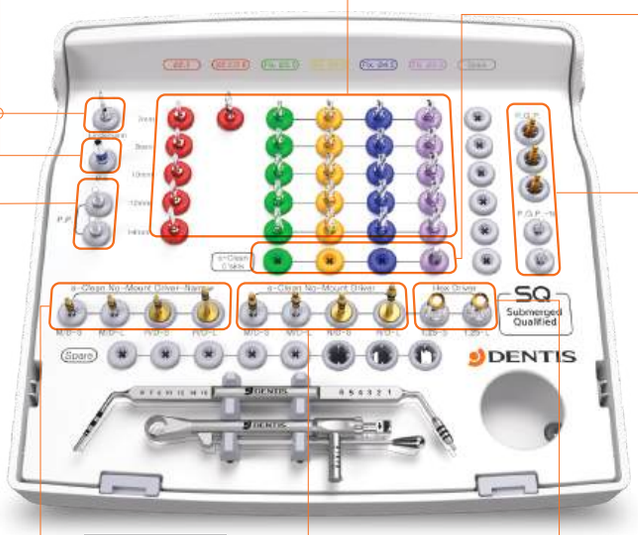

Код – DSQKN

Динамометрический ключ

DTR

Пин параллельности (для сверла)

DSQPP

Имплантовод машинный и ручной

Узкий

DSNDSS
DSNDSL

DSRDSS
DSRDSL

Имплантовод машинный и ручной

Стандартный

DSNDS
DSNDL

DRMDSS
DRMDSL

1.25 Hex отвертка

DRHDS125
DRHDL125

Пин параллельности (для имплантата)

DSQPGPS DSQPGPR

Последовательность сверления

- Дизайн свёрел обеспечивает сверление на 0.6 мм глубже длины имплантата SQ.
- Имплантат SQ устанавливается на 0.5 мм ниже уровня кости.

∅ 3.0 × 10 мм

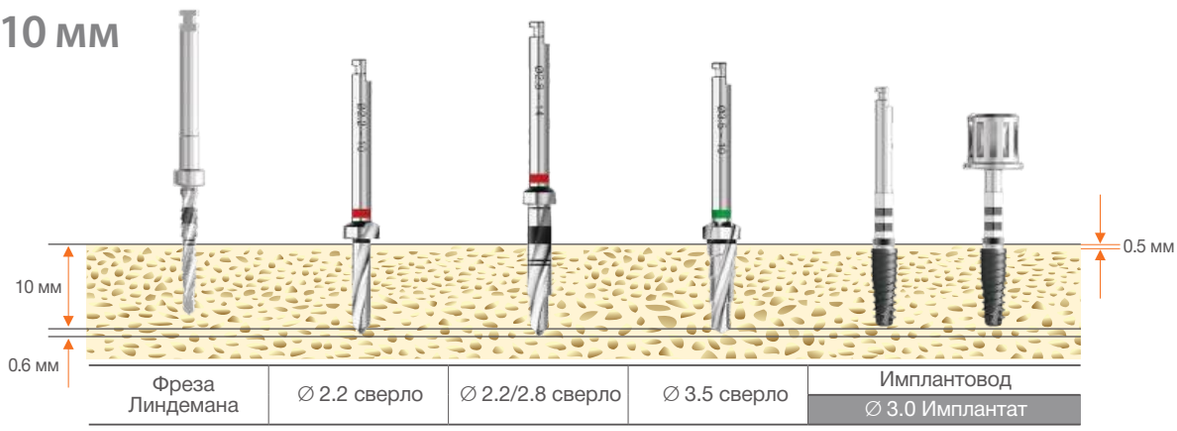

* Рекомендуемые обороты: фреза Линдемана 1200 - 1500 об/мин, сверла: 800 - 1200 об/мин.

∅ 3.5 × 10 мм

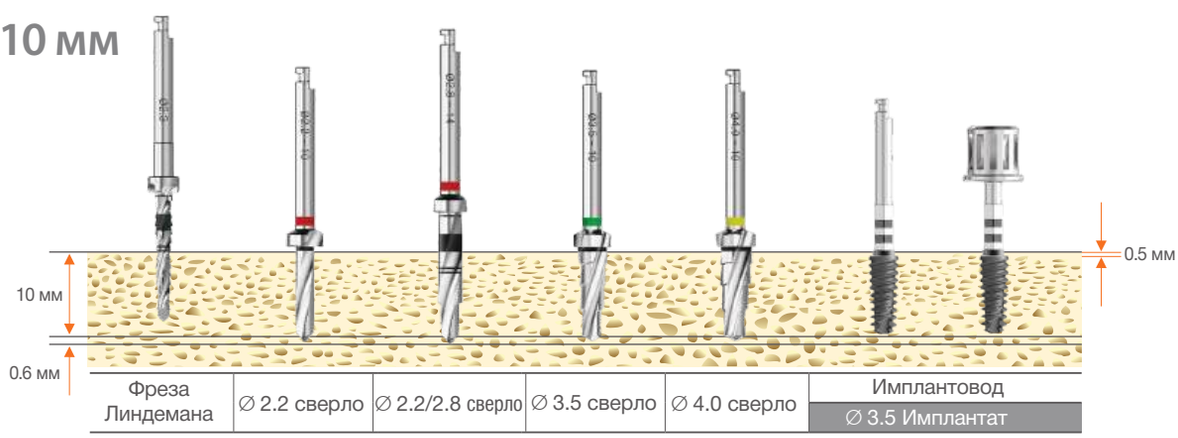

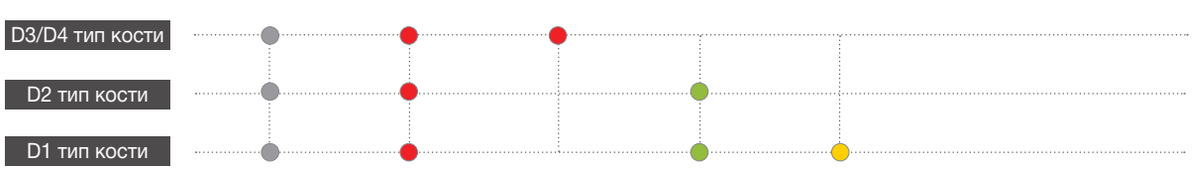

* Рекомендуемые обороты: фреза Линдемана 1200 - 1500 об/мин, сверла: 800 - 1200 об/мин.

SQ Последовательность сверления

∅ 4.0 × 10 мм

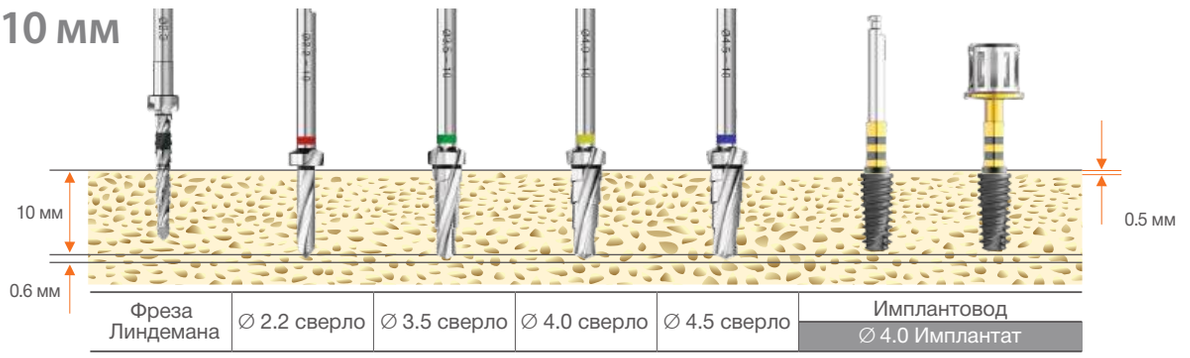

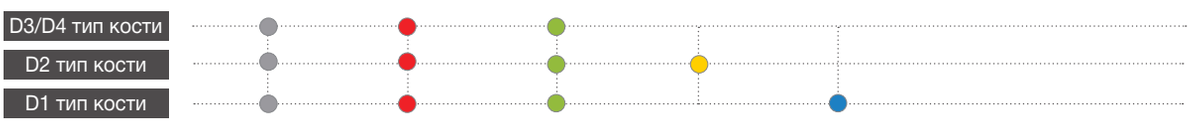

* Рекомендуемые обороты: фреза Линдемана 1200 - 1500 об/мин, сверла: 800 - 1200 об/мин.

∅ 4.5 × 10 мм

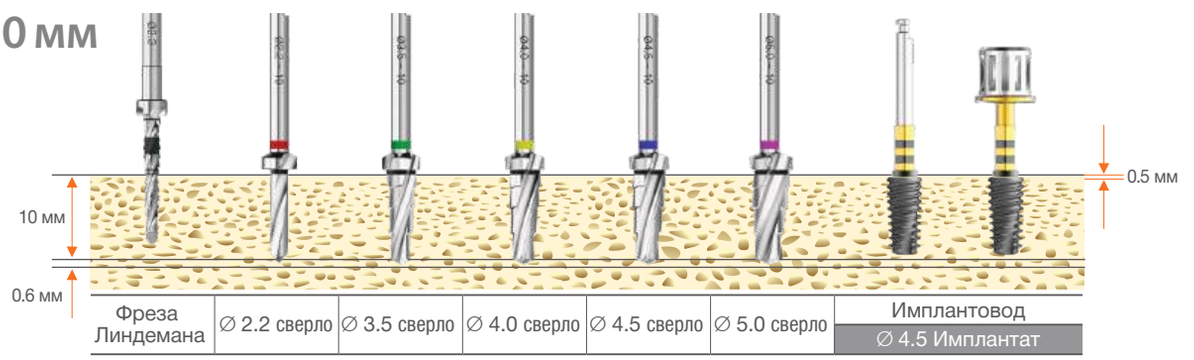

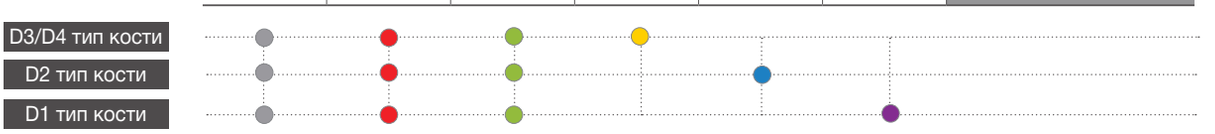

* Рекомендуемые обороты: фреза Линдемана 1200 - 1500 об/мин, сверла: 800 - 1200 об/мин.

∅ 5.0 × 10 мм

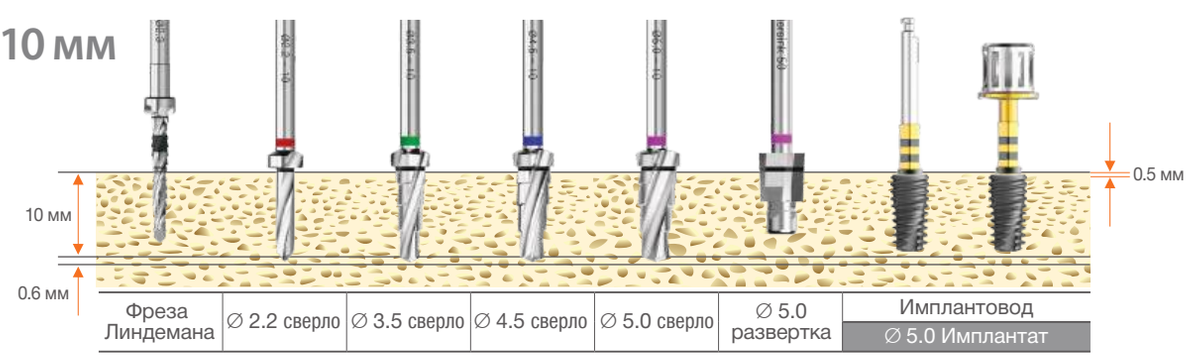

* Рекомендуемые обороты: фреза Линдемана 1200 - 1500 об/мин, сверла: 800 - 1200 об/мин.

Навигационная система SQ GUIDE

Преимущества навигационной хирургии

ЦИФРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
сведение риска ошибки к минимуму

НЕМЕДЛЕННАЯ НАГРУЗКА
уменьшение дискомфорта в период после операции и повышение лояльности со стороны пациентов

ХИРУРГИЯ БЕЗ ОТКИДЫВАНИЯ ЛОСКУТА
значительное снижение инвазивности

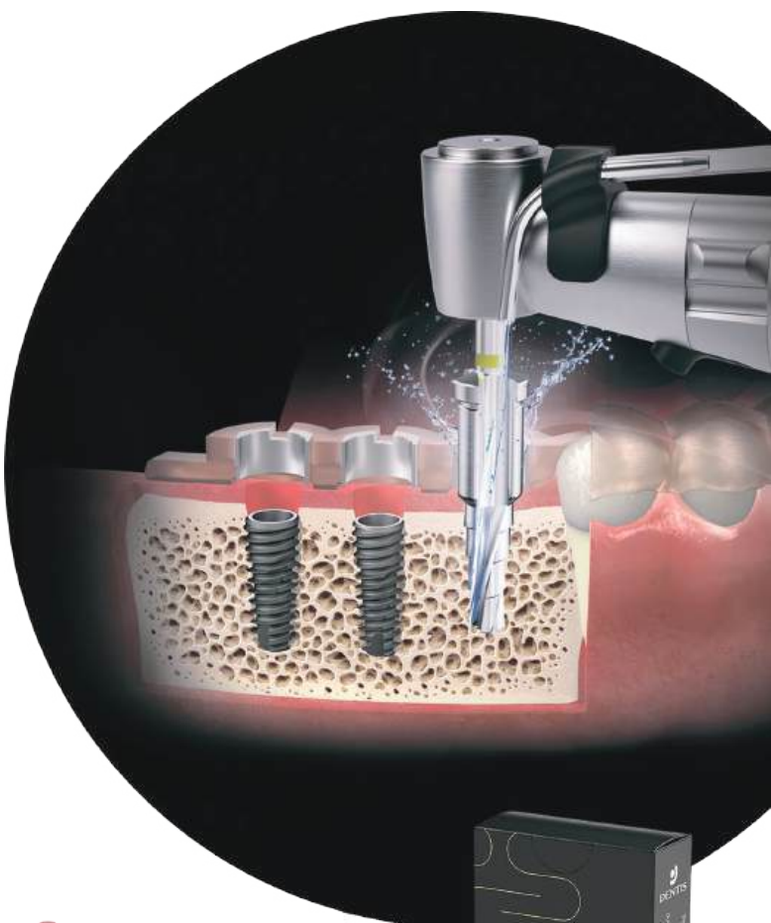

Набор для навигационной хирургии SQ Guide

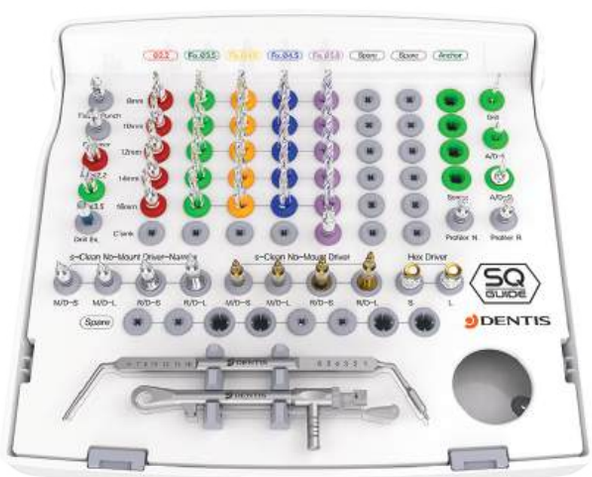

Код
DSQGK

Титановая втулка SQ GUIDE

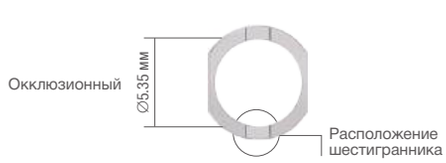



Короткая

Длинная

Диаметр (внутренний), мм	Высота, мм	Код
5.3	3.5	DSQGS35
	4.5	DSQGS45

SQ SINUS GUIDE

ЗАКРЫТЫЙ СИНУС-ЛИФТИНГ–
ЭТО ПРОСТО!

Набор для выполнения закрытого синус-лифтинга через хирургический шаблон без откидывания лоскута

Безопасно, быстро, удобно!

- Безопасное поднятие мембраны благодаря атравматичным фрезам и сверлению на низких оборотах.
- Эффективное поднятие мембраны даже при сложном рельефе гайморовой пазухи.
- Закрытый синус-лифтинг через хирургический шаблон!

Код
DSQSGK

Последовательность протезирования для системы SQ

Слепок с уровня имплантата / Цементируемые реставрации / Винтовая фиксация

Ⓝ Узкая платформа

Описание	Последовательность	Инструменты
Винт		Hex отвертка диаметром 1.25 мм
Лабораторный аналог	Ⓝ	
Слепочный трансфер	С Hex, Без Hex: Ⓝ Для открытой ложки С Hex, Без Hex: Ⓝ Для закрытой ложки	Hex отвертка диаметром 1.25 мм
Абатмент	С Hex, Без Hex: Ⓝ Прямой С Hex, Без Hex: Ⓝ UCLA абатмент с кобальт-хромовым основанием С Hex, Без Hex: UCLA пластиковый абатмент 15° 25°: Ⓝ Угловой С Hex, Без Hex: Ⓝ Титановый С Hex, Без Hex: Ⓝ Пластиковый Временный	Hex отвертка диаметром 1.25 мм
	Винт-заглушка Формирователь десны	Hex отвертка диаметром 1.25 мм
Имплантат	Ⓝ SQ ∅3.0 – 3.5 SQ ∅4.0 – 8.0	Машинный имплантовод Ручной имплантовод

Формирователь десны

Рекомендуемый торк – 10 Н/см

Узкий

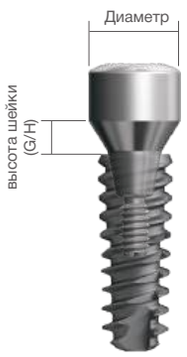

Диаметр, мм	Высота шейки, мм	Код
4.0	1.0	DSHS4010
	1.5	DSHS4015
	2.0	DSHS4020
	2.5	DSHS4025
	3.5	DSHS4035
	4.5	DSHS4045

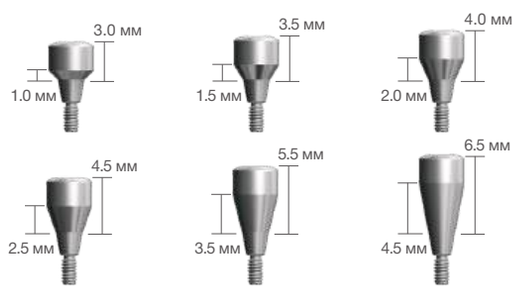

Стандартный/широкий

Диаметр, мм	Высота шейки, мм	Код
4.5	1.0	DSH4510
	1.5	DSH4515
	2.0	DSH4520
	2.5	DSH4525
	3.5	DSH4535
	4.5	DSH4545
	5.5	DSH4555

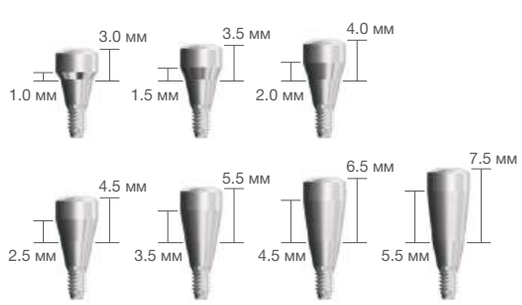

Диаметр, мм	Высота шейки, мм	Код
5.5	1.0	DSH5510
	1.5	DSH5515
	2.0	DSH5520
	2.5	DSH5525
	3.5	DSH5535
	4.5	DSH5545
	5.5	DSH5555

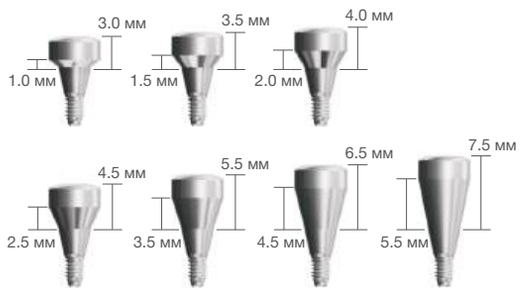

Диаметр, мм	Высота шейки, мм	Код
6.5	1.5	DSH6515
	2.0	DSH6520
	2.5	DSH6525
	3.5	DSH6535
	4.5	DSH6545
	5.5	DSH6555

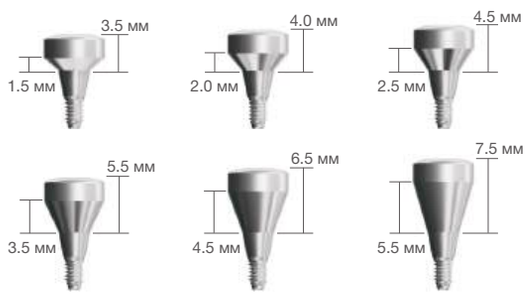

Диаметр, мм	Высота шейки, мм	Код
7.5	1.5	DSH7515
	2.0	DSH7520
	2.5	DSH7525
	3.5	DSH7535
	4.5	DSH7545
	5.5	DSH7555

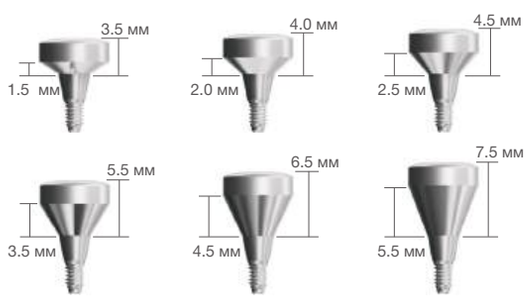

Скан формирователи десны

Диаметр, мм	Высота шейки, мм	Hex 1.25
4.8	2.0	DSSH4820S
	3.0	DSSH4830S
	4.0	DSSH4840S
	5.0	DSSH4850S
5.8	4.0	DSSH5840S
	5.0	DSSH5850S
6.8	4.0	DSSH5850S

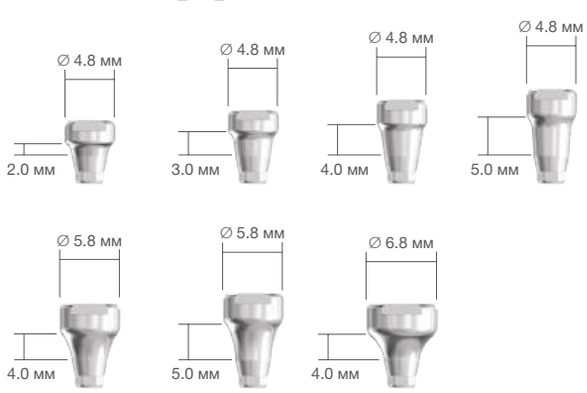

Мульти Юнит система

Большой диапазон высоты десны (G/H)

Прямой	1.5 / 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 мм
Угловой 17°	1.5 / 2.5 / 3.5 / 4.5 мм
Угловой 30°	1.5 / 2.5 / 3.5 / 4.5 мм

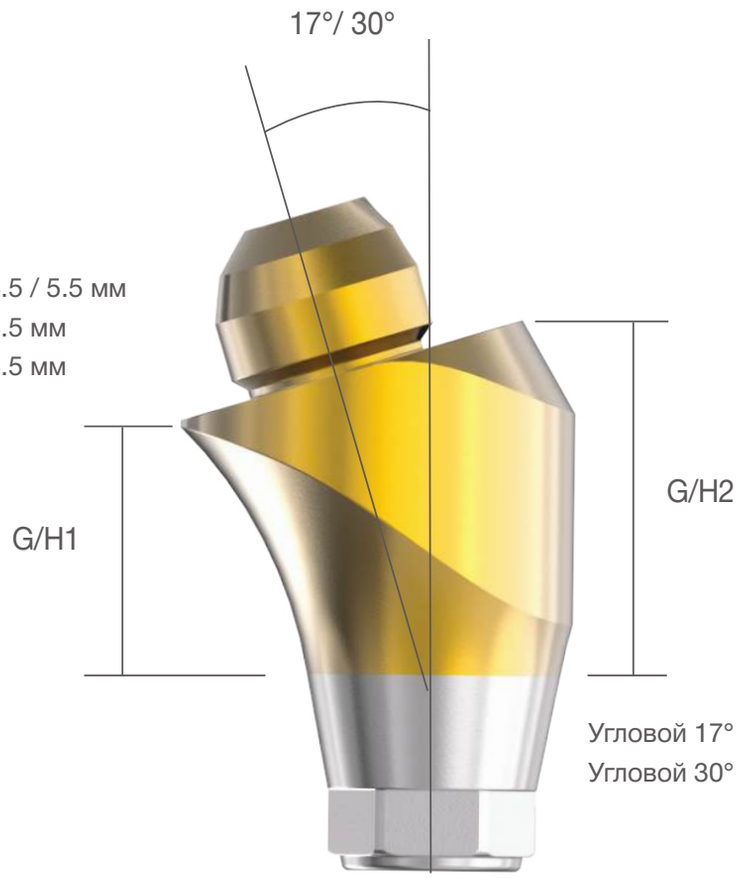

Угловой 17°	3 / 4 / 5 / 6 мм
Угловой 30°	4 / 5 / 6 / 7 мм

Стандартная платформа

Сочетание Сканбоди и Цифрового лаболаторного аналога

- Возможна работа по цифровому протоколу
- Библиотеки CAD/CAM (3shape / Exocad)

Сканбоди

МЮ Цифровой лабораторный аналог

Последовательность протезирования для Мульти Юнит абатментов

Ⓝ Узкая платформа

Описание	Последовательность	Инструмент
Винт	для Мульти Юнит цилиндра	Ручная Hex отвертка ∅ 1.25 мм
Цилиндр	МЮ цилиндр с кобальт-хромовым основанием; МЮ временный цилиндр с винтом	
Лабораторный аналог		
Слепочный трансфер и сканбоди	Слепочный трансфер для закрытой ложки; Слепочный трансфер для открытой ложки; Сканбоди	Ручная Hex отвертка ∅ 1.25 мм
МЮ защитный колпачок		Ручная Hex отвертка ∅ 1.25 мм
Абатмент	Ⓝ прямой; Ⓝ угловой	Ручная отвертка для Мульти Юнит; Ручная Hex отвертка ∅ 1.25 мм
	Заглушка; Формирователь десны	Ручная Hex отвертка ∅ 1.25 мм
Имплантат	Ⓝ SQ ∅ 3.0–3.5; SQ ∅ 4.0–8.0	Машинный имплантовод; Ручной имплантовод

Мульти Юнит система

МЮ прямой абатмент с держателем (в комплекте)

Узкий (рекомендуемый торк – 20 Н/см)

Диаметр, мм	Высота десны	Код
4.8	1.5	DSMUSN15S
	2.5	DSMUSN25S
	3.5	DSMUSN35S
	4.5	DSMUSN45S
	5.5	DSMUSN55S

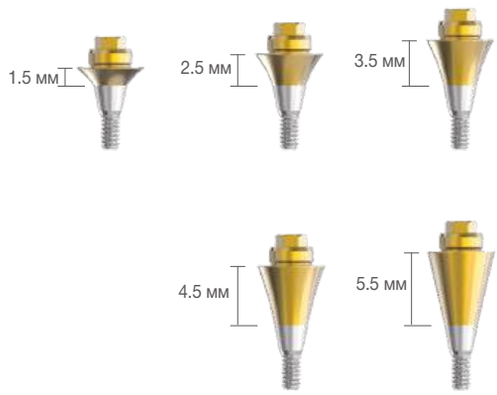

Стандартный (рекомендуемый торк – 30 Н/см)

Диаметр, мм	Высота десны	Код
4.8	1.5	DSMUS15S
	2.5	DSMUS25S
	3.5	DSMUS35S
	4.5	DSMUS45S
	5.5	DSMUS55S

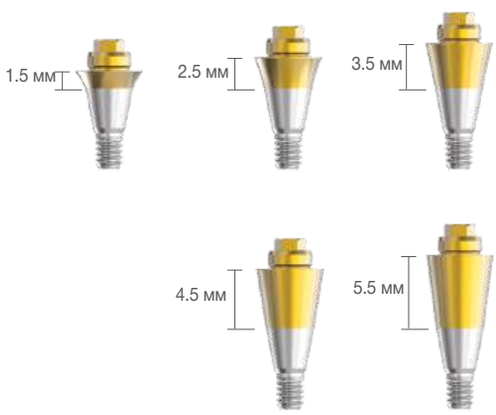

МЮ угловой абатмент с держателем и винтом (в комплекте)

Узкий (рекомендуемый торк – 20 Н/см)

Диаметр, мм	Размер шести-гранника	Угол наклона	Высота десны 1	Высота десны 2	Код
4.8	1.7 2Hex	17°	1.5	3	DSMUAN1715S
			2.5	4	DSMUAN1725S
			3.5	5	DSMUAN1735S
			4.5	6	DSMUAN1745S
		30°	1.5	4	DSMUAN3015S
			2.5	5	DSMUAN3025S
			3.5	6	DSMUAN3035S
			4.5	7	DSMUAN3045S

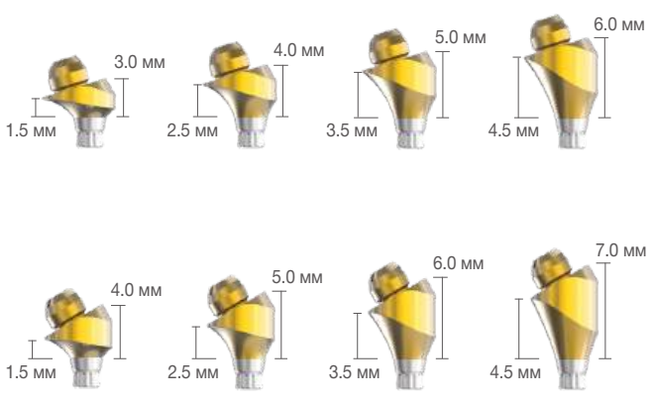

Стандартный (рекомендуемый торк – 30 Н/см)

Диаметр, мм	Размер шести-гранника	Угол наклона	Высота десны 1	Высота десны 2	Код
4.8	2.5 Hex	17°	1.5	3	DSMUA1715S
			2.5	4	DSMUA1725S
			3.5	5	DSMUA1735S
			4.5	6	DSMUA1745S
		30°	1.5	4	DSMUA3015S
			2.5	5	DSMUA3025S
			3.5	6	DSMUA3035S
			4.5	7	DSMUA3045S

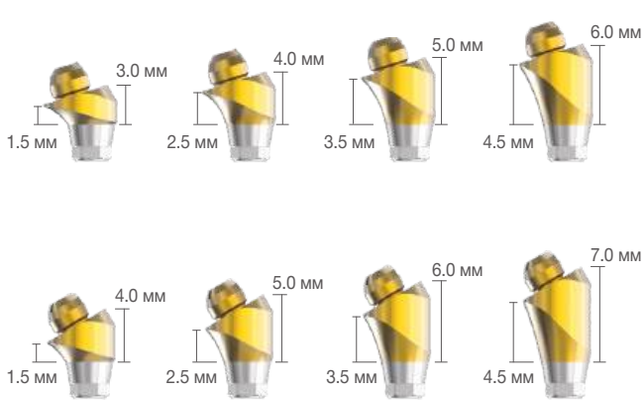

МЮ Ручная отвертка

Код
DSMUSD

Для установки прямых Мульти Юнит абатментов

Слепочный трансфер

	Код
МЮ слепочный трансфер для закрытой ложки с винтом	DSMUTICSS
МЮ слепочный трансфер для открытой ложки с винтом	DSMUPICSS

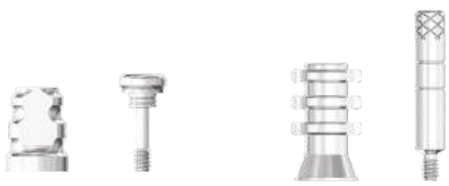

МЮ Цилиндр

	Код
МЮ цилиндр с кобальт-хромовым основанием с винтом	DSMUCCS
МЮ временный цилиндр с винтом	DSMUTCS

Винт для МЮ цилиндра

Код
DSMUCS



Винт для МЮ углового абатмента

Код
DSMUS

МЮ защитный колпачок с встроенным винтом

Код
DSMUHC

МЮ лабораторный аналог прямого абатмента

Код
DSMUSDL

Титановое основание для МЮ абатментов

Код
DSMUTBSS
DSMUTBLS

Сканбоди для МЮ с коротким винтом

Код
DSMUSBSS
DSMUSBLS

Для точной передачи анатомии зубной дуги рекомендуем использовать совместимые Сканбоди Pro – узнайте больше на стр. 34

Схема протезирования для CAD/CAM абатментов

Описание	Последовательность	Инструменты
Лабораторный аналог	Цифровой лабораторный аналог	
Скан Боди	Скан Боди	
Титановое основание	Титановое основание	Ручная Hex отвертка ∅ 1.25 мм
Заглушка/ формирователь	Винт-заглушка Формирователь десны	Ручная Hex отвертка ∅ 1.25 мм
Имплантат SQ	SQ ∅3.0 – 3.5 SQ ∅4.0 – 8.0	Машинный имплантовод Ручной имплантовод

CAD/CAM Элементы

Титановые основания

Титановые основания используются при изготовлении индивидуальных абатментов из диоксида циркония с помощью технологии CAD/CAM.

Узкий

Рекомендуемый торк: 20 Нсм

Диаметр абатмента, мм	Тип	Высота	Код
4.0	с Hex	1.0	DSLAN401045HS
		2.0	DSLAN402045HS
		3.5	DSLAN403545HS
		5.0	DSLAN405045HS
	без Hex	1.0	DSLAN401045NS
		2.0	DSLAN402045NS
		3.5	DSLAN403545NS
		5.0	DSLAN405045NS

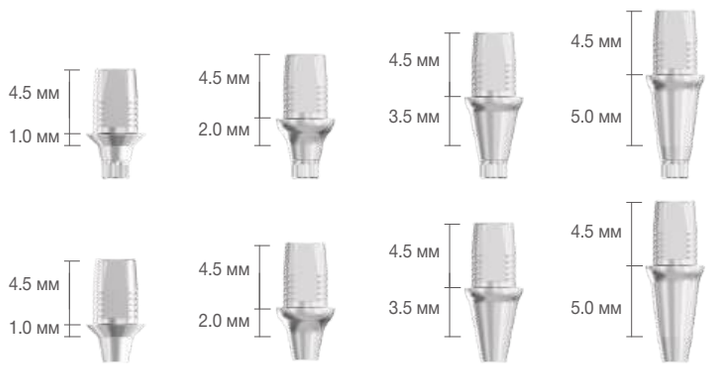

Стандартный

Рекомендуемый торк: 30 Нсм

Диаметр абатмента, мм	Тип	Высота	Код
4.8	с Hex	1.0	DSLAR481045HS
		2.0	DSLAR482045HS
		3.5	DSLAR483545HS
		5.0	DSLAR485045HS
	без Hex	1.0	DSLAR481045NS
		2.0	DSLAR482045NS
		3.5	DSLAR483545NS
		5.0	DSLAR485045NS

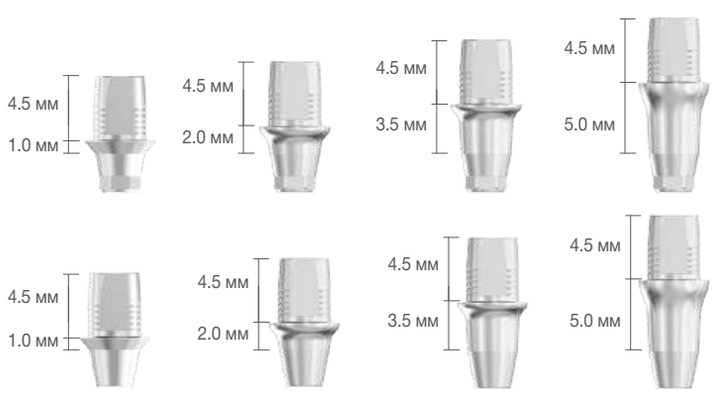

Цифровой лабораторный аналог

Цифровые лабораторные аналоги применяются для изготовления моделей на 3D-принтере.

Тип платформы	
Узкий ∅4.0	Стандартный ∅4.5
DSDLANS	DSDLARS

Сканбоди

Винт

Узкий Стандартный

Узкий

Диаметр, мм	Длина, мм	Код
4.0	8.0	DSSBNSS
	12.0	DSSBNLS
	16.0	DSSBNELS

Стандартный

Диаметр, мм	Длина, мм	Код
4.5	8.0	DSSBRSS
	12.0	DSSBRLS
	16.0	DSSBRELS

DENTIS

СКАНБОДИ PRO

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

Современное решение при протезировании.
Первые на рынке скан маркеры
с направляющими пинами.

1 Непрерывное сканирование

- Точность
- Предсказуемость
- Удобство

2 Для сложных случаев

- All-on-X протезирование
- Одномоментная имплантация в широкую лунку

3 6 вариантов пинов

Вкручиваются в Сканбоди и друг в друга

Позволяет легко воссоздать анатомическую форму зубной дуги!

Сканбоди Pro

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТОЧНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Сканбоди Pro с уровня Мульти Юнита

Высота, мм	Диаметр, мм
10.0	4.5
DSMUSBLFS	

Сканбоди Pro с уровня имплантата

Высота, мм	Тип платформы	
12.0	Узкая ∅ 4.0 мм	Стандартная ∅ 4.5 мм
	DSSBNLFS	DSSBRLFS

Пины для Сканбоди Pro

Высота, мм	Диаметр, мм	Тип
8.0	4.0	Полукруглый
	DSSBSBC4	

Высота, мм	Диаметр, мм	Тип
8.0	4.0	Треугольный
	DSSBSBT4	

Высота, мм	Диаметр, мм		Тип
8.0	3.0	4.0	Квадратный
	DSSBSBQ	DSSBSBQ4	

Высота, мм	Диаметр, мм		Тип
8.0	3.0	4.0	Шестигранный
	DSSBSBH	DSSBSBH4	

Кейс для Сканбоди Pro

Оптимальное решение для хранения и стерилизации компонентов системы точного сканирования

Код
DSBPK

DENTIS

Дентис Имплант – официальный российский дистрибьютор всемирно известной южнокорейской компании DENTIS – производителя дентальных имплантатов SQ и OneQ, стоматологических светильников LUVIS и хирургических инструментов SAVE. Компания была основана в 2005 году, и сегодня продукцию DENTIS можно приобрести более чем в 80 странах. Компания DENTIS включена в национальную программу фундаментального развития Южной Кореи, имеет много наград и достижений. Компания проводит профессиональное обучение, научные международные конференции и симпозиумы. Продукция DENTIS сертифицирована по международным стандартам. Дентис Имплант является партнером DENTIS в России с 2008 года.

ТРИ СОБСТВЕННЫХ ЗАВОДА

Полностью автоматизированный производственный цикл.

ИННОВАЦИИ

DENTIS понимает важность развития инновационных направлений в имплантологии.
В связи с этим большое внимание уделяется разработкам в области навигационной хирургии, 3D технологий, остеопластических материалов и стоматологических светильников.

СЕРТИФИКАТ CLEAN IMPLANT FOUNDATION (CIF), ГЕРМАНИЯ

Чистота поверхности имплантатов DENTIS подтверждена независимыми европейскими исследованиями.

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

DENTIS сотрудничает с Глобальной Академией Дентальной Имплантологии GDIA, где ежегодно проходят обучение более 3000 врачей с целью повышения уровня квалификации.

СОБСТВЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

DENTIS имеет опыт 20 лет успешных разработок. Компания самостоятельно отвечает за производственный цикл: от идеи до реализации и контроля качества.

DENTIS В 80 СТРАНАХ МИРА

DENTIS производит более 10 млн имплантатов в год, которые используются более чем в 80 странах мира.

dentis-russia.ru

DENTIS

8-800-302-56-46

г. Москва, ул. Митинская, д. 36 к 1, офис 400

г. Уфа, БЦ Парк-Сити, ул. Менделеева, д.170, офис 1006